


SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE
CON SPORTELLO APERTO

Riferimento	1	2	3	4	5	6
Utenza			AUSILIARI		LAMPADA RX	TRAF0 TAC
Potenza		350 VA			220	380
Tensione	V	380				
Poli	n.					
Corrente	A					
Interruttore	Corr. nominale	A	4x160		2X6A	3x160 A
	Taratura	A				
	Idn	mA				
	Tipo					
Fusibile	Accessori					
	Taratura	A	2	20	125 ritard.	
	Tipo					
Contattore	Corr. nominale	A		3x150		
	Tens. Bobina	V				
	Tipo					
Trasformatore	Accessori					
	Tensione		220/24V			
Fusibile						
Sezione		2x2,5mmq+T	2x2,5mmq+T		2x1,5mmq+T	3x50mmq+T
Lunghezza Linea						
N O T E						AL TRAF0 380/480V (PHILIPS)

AZ. OSPEDALIERA "CANNIZZARO" -CATANIA-

TAC/PET		N.	DATA	DISEGN.	VISTO	SETTORE
QUADRO ELETTRICO - CIRCUITO DI POTENZA		.				
NRLCOMMESSA :	SCALA :	NUMERO :				
DISEGNATORE : A. GALBIATI	UNITA' :	75.021.08.203				
VISTO :		FOGLI: 04, FOGLIO : 01				
Philips Medical Systems S.p.A. - MONZA (ITALY)			DATA : 02/03/2006	FORMATO : A3		

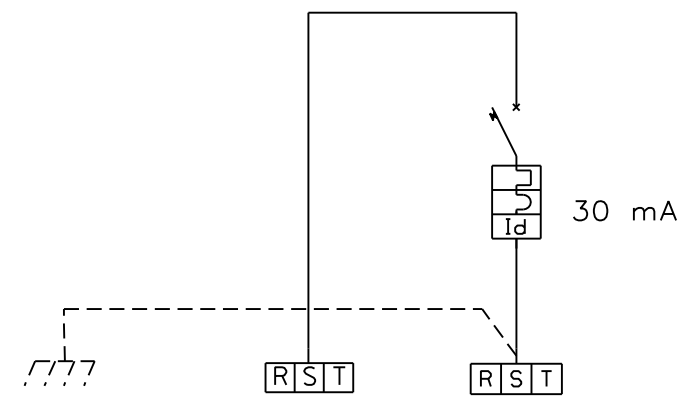


Riferimento	1	2
Utenza		TAC (GANTRY)
Potenza		
Tensione	V	480
Poli	n.	
Corrente	A	
Interruttore	Corr. nominale	A
	Taratura	A
	Idn	mA
	Tipo	
Fusibile	Accessori	
	Taratura	A
	Tipo	
Contattore	Corr. nominale	A
	Tens. Bobina	V
	Tipo	
Trasformatore	Accessori	
	Tensione	V
Fusibile		
Sezione	3x35mmq+T	3x35mmq+T
Lunghezza Linea		
N O T E		

"D" - CARATTERISTICA DIINTERVENTO MAGNETOTERMICO SECONDO NORME

AZ. OSPEDALIERA "CANIZZARO" -CATANIA-

TAC/PET		N.	DATA	DISEGN.	VISTO	SETTORE
QE 2 - CIRCUITO DI POTENZA		.				
NRLCOMMESSA :	SCALA :	NUMERO :				
DISEGNATORE : A. GALBIATI	UNITA' :	75.021.08.203				
VISTO :		FOGLI: 04, FOGLIO : 03				
Philips Medical Systems S.p.A. - MONZA (ITALY)			DATA : 02/03/2006	FORMATO : A3		

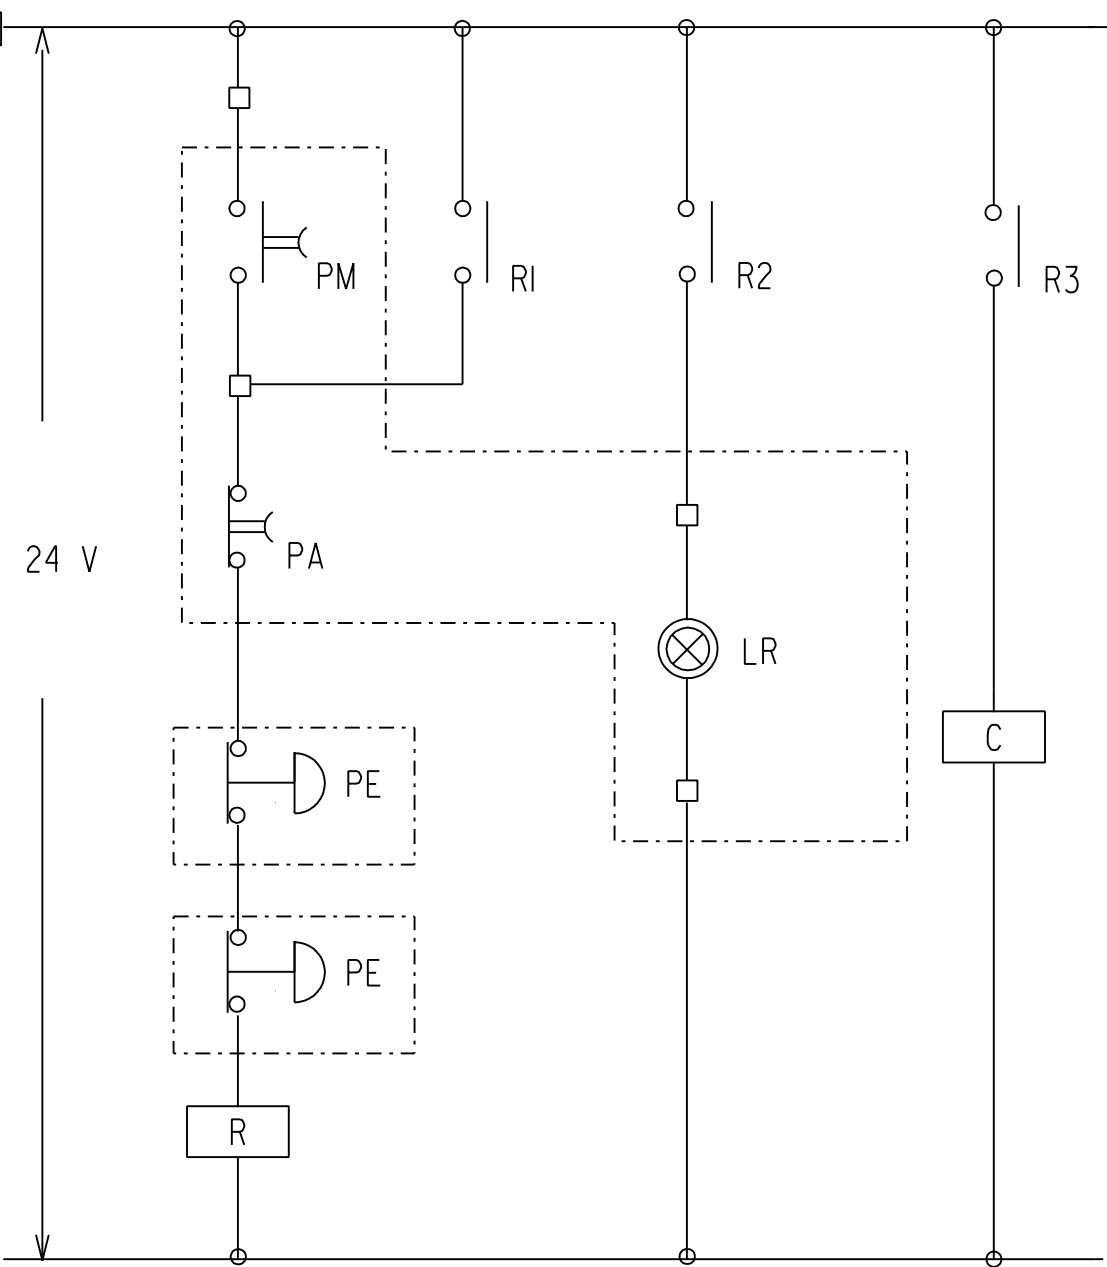

PM	PULSANTE DI MARCIA IN CAMPO
PA	PULSANTE DI ARRESTO IN CAMPO
LR	LAMPADA SEGNALAZIONE
C	BOBINA CONTATTORE LINEA
CI	CONTATTI AUSILIARI
PE	PULSANTE DI EMERGENZA A FUNGO
R	RELE' AUSILIARIO I° 24V
RI-R2-R3	CONTATTI AUSILIARI RELE' AUX (R)

AZ. OSPEDALIERA "CANNIZZARO" -CATANIA-

TAC/PET		N.	DATA	DISEGN.	VISTO	SETTORE
QUADRO ELETTRICO -CIRCUITI AUSILIARI		.				
NRLCOMMESSA :	SCALA :	NUMERO :				
DISEGNATORE : A. GALBIATI	UNITA' :	75.021.08.203				
VISTO :		FOGLI: 04, FOGLIO : 02				
Philips Medical Systems S.p.A. - MONZA (ITALY)			DATA : 02/03/2006	FORMATO : A3		

3F+N+T 380V
100KVA3F+T 380V
CAVO 3x50mmq + TERRA
(*)TRAFO (PHILIPS)
MCT 100/480V ISOTRAN PLUS
110 KVA3F +T 480V
CAVO 3x35mmq + TERRA
(*)3F +T 480V
CAVO 3x35mmq + TERRA
(*)

GANTRY TAC

NOTE

(*) CAVI NON FORNITI A CORREDO DELL'APPARECCHIATURA DA PREDISPORRE A CURA
DELL' ELETTRICISTA DEL CLIENTE O NEL CASO DI CHIAVI IN MANO DALL' IMPIANTISTA)

AZ. OSPEDALIERA "CANIZZARO" -CATANIA-

TAC/PET		N.	DATA	DISEGN.	VISTO	SETTORE
SCHEMA COLEGAMENTI		.				
NRLCOMMESSA :	SCALA :	NUMERO :				
DISEGNATORE : A. GALBIATI	UNITA' :	75.021.08.203				
VISTO :		FOGLI: 04, FOGLIO : 04				
Philips Medical Systems S.p.A. - MONZA (ITALY)			DATA : 02/03/2006	FORMATO : A3		