



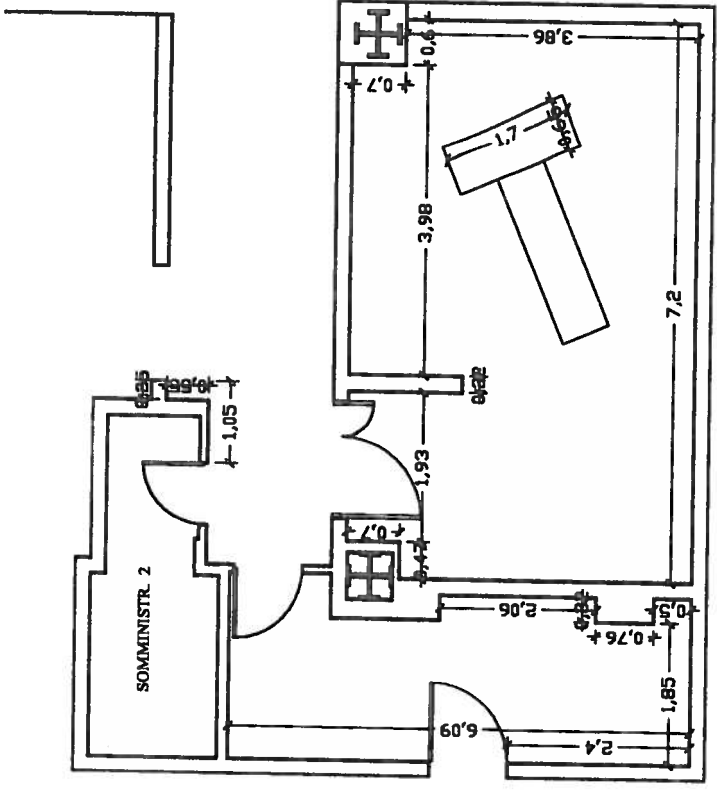

SITUAZIONE ESISTENTE
PIANO SUPERIORE (-2)

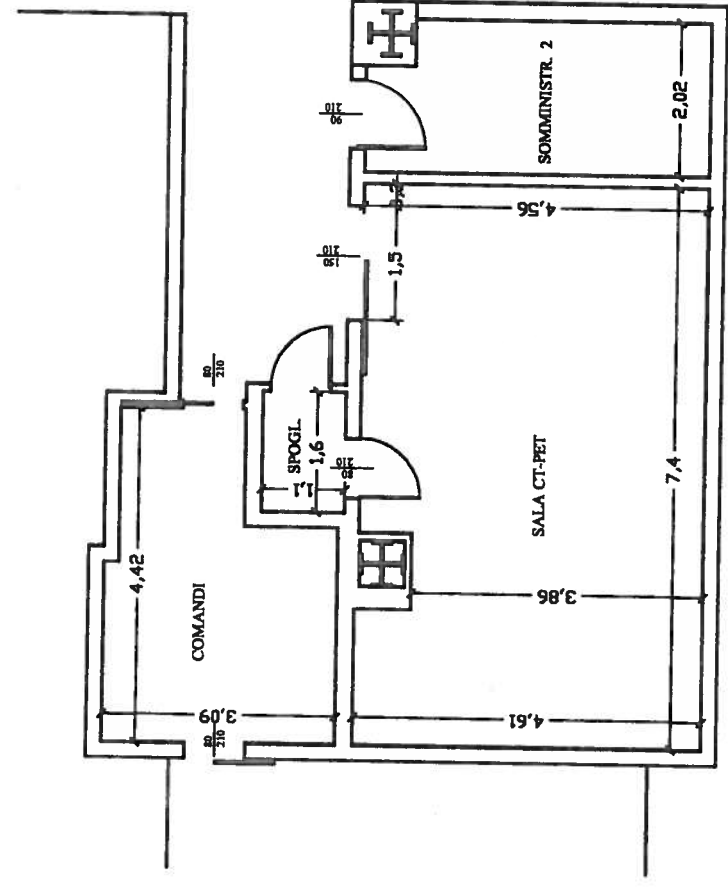


SITUAZIONE DI PROGETTO QUOTATA
PIANO SUPERIORE (-2)

PROTEX METRA

FRACIAZICI VAGNETICHE



GE Medical Systems Italia

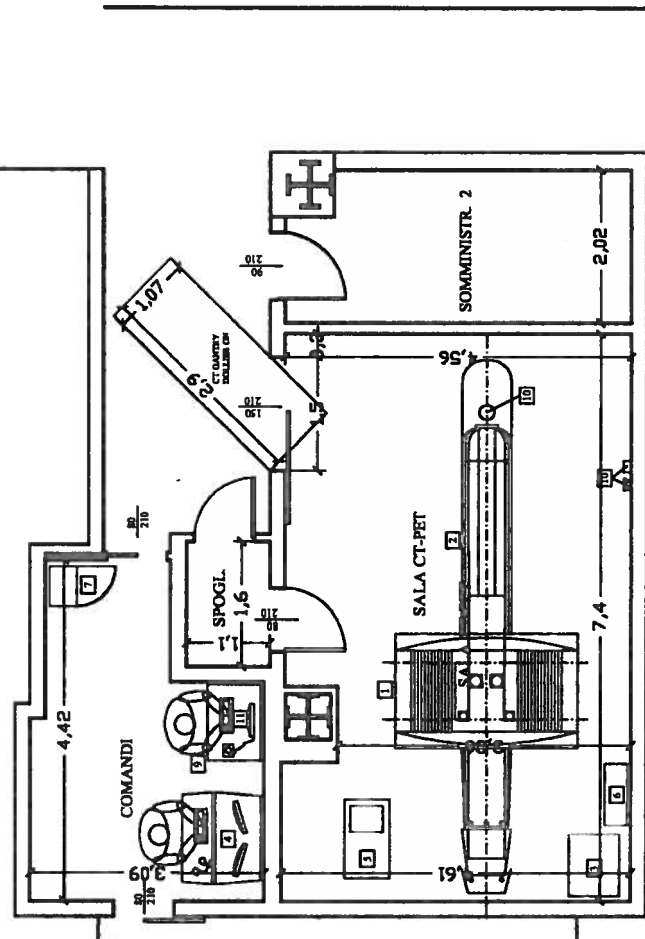

**SITUAZIONE DI PROGETTO ARREDATA
PIANO SUPERIORE (-2)**

La voce: contrassegna da " sono fornita ad natolite a cura della GE secondo il contratto di vendita e le condizioni di fornitura

Le restanti voci: nel caso di fornitura chiavi, le mono, saranno fornite da GE o dall'azienda assegnataria da aver secondo il contratto di fornitura

CONDIZIONI D'ESERCIZIO

SALA	CT/PET	TEMPERATURA		DISECCAZIONE
		minima	massima	
SALA CONANDI	18° C	26° C	27° C	18-20
	18° C	26° C	27° C	2-40

variazione di temperatura $\leq 3^{\circ}\text{C/h}$
 Umidità relativa da 30% a 80% NON CONDENSANTE
 variazione di umidità relativa $\leq 5\%/h$

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

LINEA TRIFASE 380/480V + N + T (+/-10%) 50 HZ (+/-3%)
 MASSIMA POTENZA MOMENTANEA 150 kW @ 0.85 PF
 POTENZA CONTINUA RICHIESTA 30 kW


e scritta della GE Medical Systema Italia S.p.A., proprietaria di questo elaborato.

PROGETTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UNA APPARECCHIATURA PET/CT "Discovery PET/CT 990"	ITL N. 001804/10	
	DISEGNO N.	REV. N.
	03	1
	DATA	17.05.2010
LEGENDA APPARECCHIATURE	SCALA	/
	DISEGNAIORE	APPROVAZIONE
P. F.	V. D.	OSPEDALE CANNIZZARO -CATANIA-



GE Medical Systems Italia

SENIOR PLANNING
-E-Medical Systems - c/o A.M.C. Sede Legale
Via G. Galilei 36 20126 Milano - Italia
Tel. +39 2 26001111 Fax +39 2 26001116

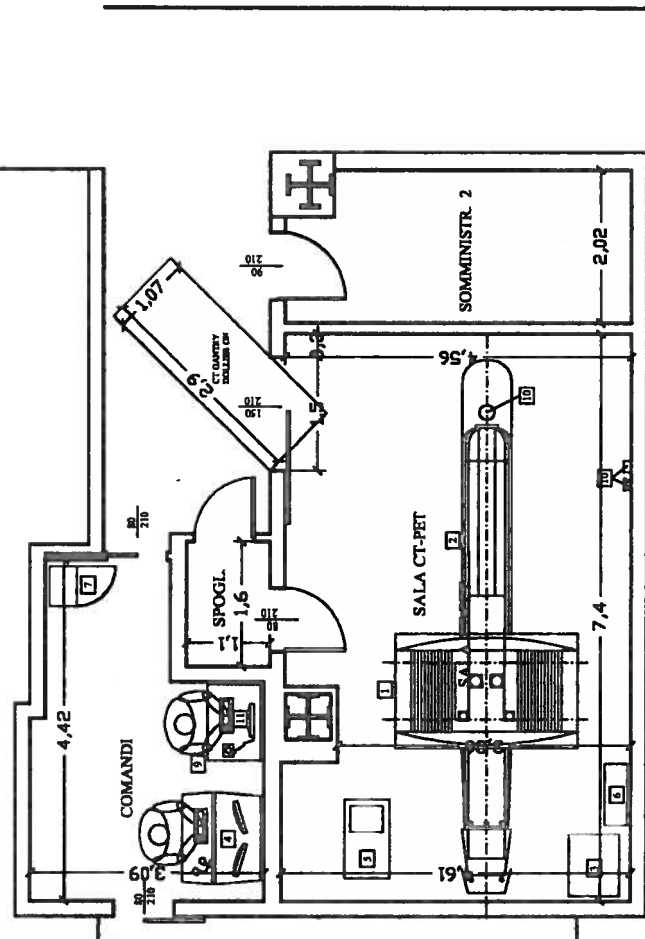


**SITUAZIONE DI PROGETTO ARREDATA
PIANO SUPERIORE (-2)**



GE Medical Systems Italia

SEMI-ANNUAL PLANNING

È proibita la riproduzione anche parziale o il trasferimento o terzi di quanto contenuto in questa tavola senza autorizzazione.

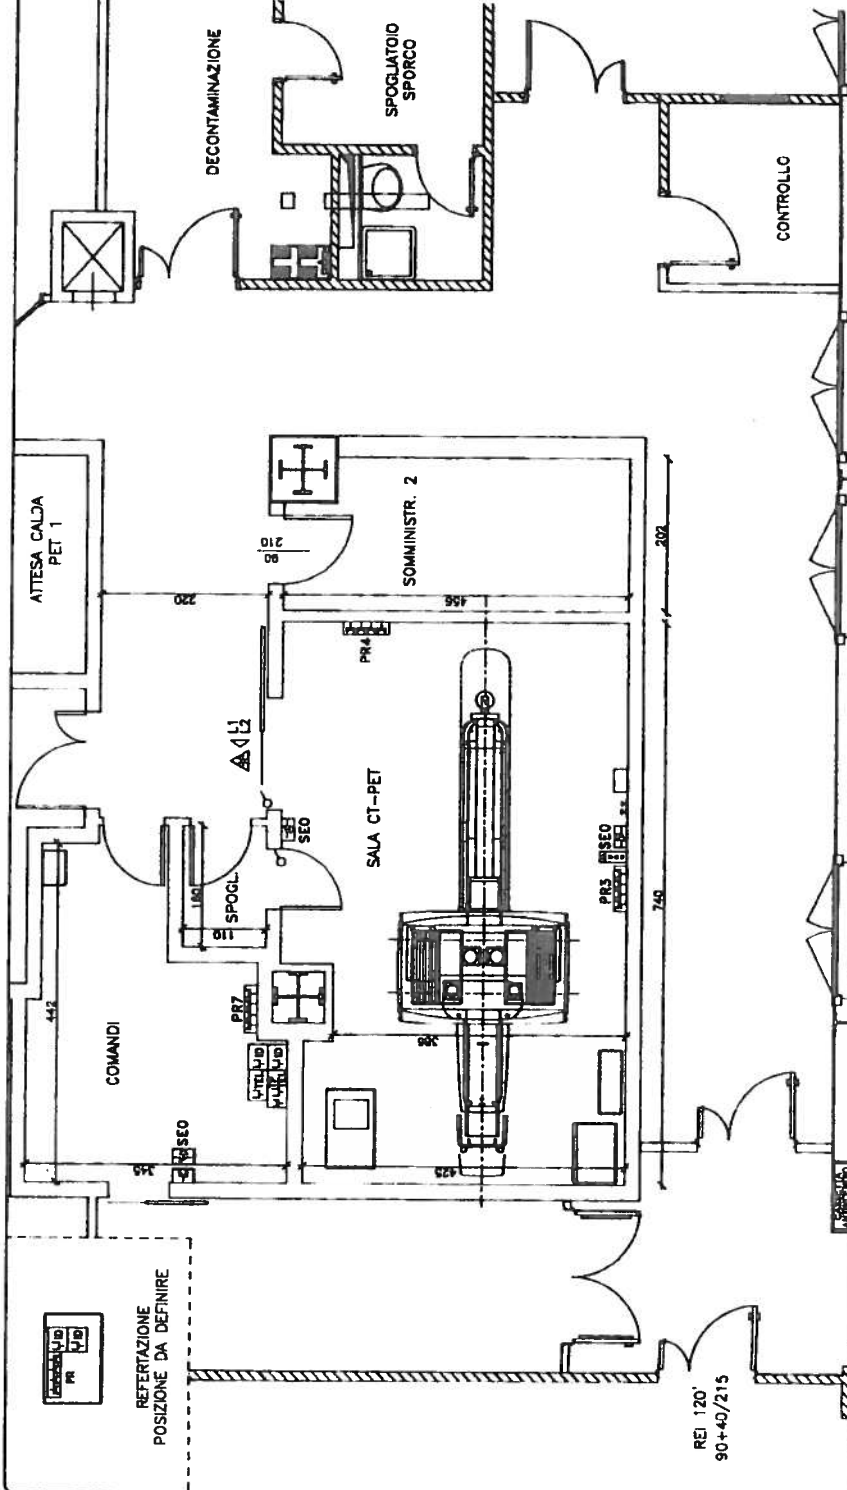[illegible]

E' proibita la riproduzione anche parziale o il trasferimento a terzi di quanto contenuto in questa tavola senza autorizzazione scritta della GE Medical Systems Italia S.p.A. promotori di questa elaborazione.

GE Medical Systems Italia

UF Medicine Systems Inc - UF Office Sede Legale
In Condomínio 36-20126 - Valparaíso Chile
Tel +59 2 25607881 Fax +59 2 26001135

OGGETTO	PROGETTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UNA APPARECCHIATURA PET/CT "Discovery PET/CT 690"				
COMITENTE	INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE OPERE IMPIANTISTICHE				
	OSPEDALE CANNIZZARO -CATANIA-				
FILE N.	ml804/10	DETERMINA N.	04	DATA	17.05.21
		DETERMINA N.	150	APPROVAZIONE	V. D.